START
INSTELLINGEN > BEDIENING

1 Welke oogmodule schikt jou?

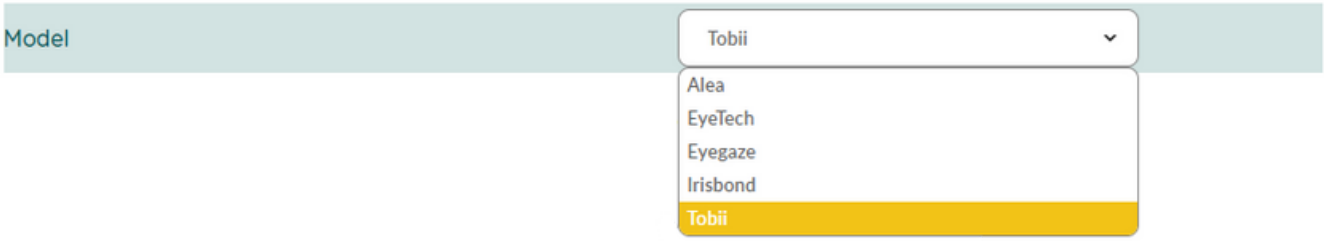

2 Pikt de oogmodule je ogen op? Correcte positie (1) en afstand (2-3)?

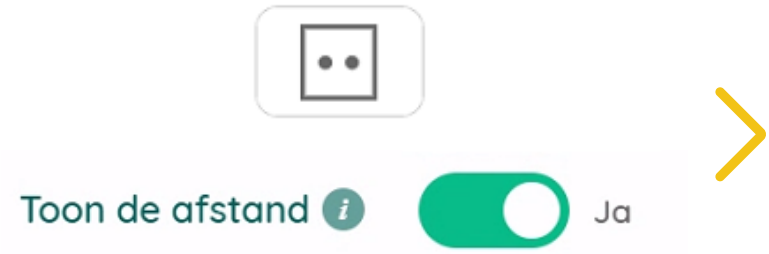

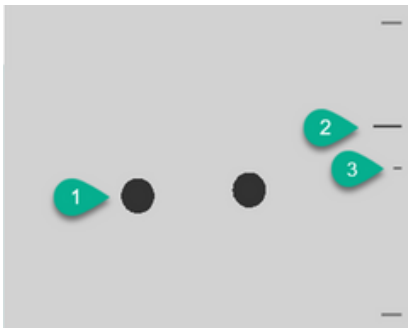

3 Pikt de module je blikrichting op? Kalibreren!

START
GOOD TO KNOW

1 Camera. Wat gaat de oogmodule volgen?

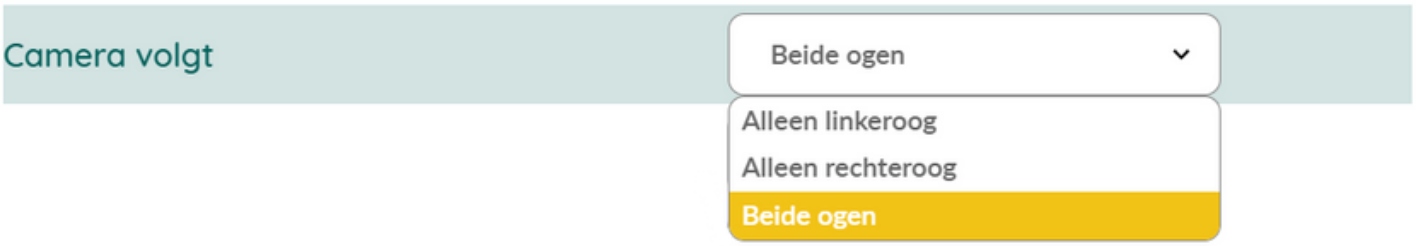

2 Kan de module je ogen oppikken?
In je document: oogmonitor in pauzevak ter controle.

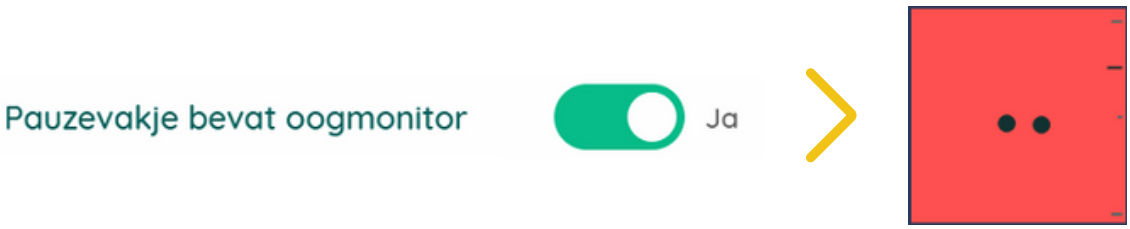

3 Pikt de module je blikrichting op? Je kan de kalibratie personaliseren.

TIJDENS HET GEBRUIK
IN DE PRAKTIJK

Via acties in je ME5-document

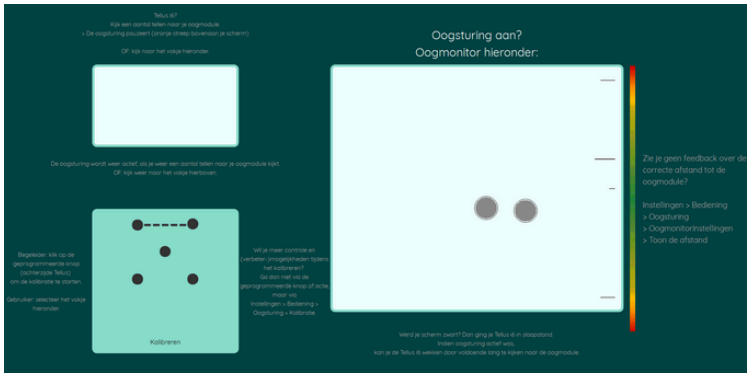

Illustratie bedieningsacties: in 'regie over je spraakcomputer', 'MaximEyes' of 'AlphaCore' (Menu > Importeren > Online documenten)

Via de programmeerbare knoppen van de Tellus

Meer info in de handleiding of in de instructievideo van het FAQ-item 'starten met je spraakcomputer'

TIJDENS HET GEBRUIK
KALIBRATIE

Via acties of programmeerbare knoppen;
resultaat verdwijnt automatisch

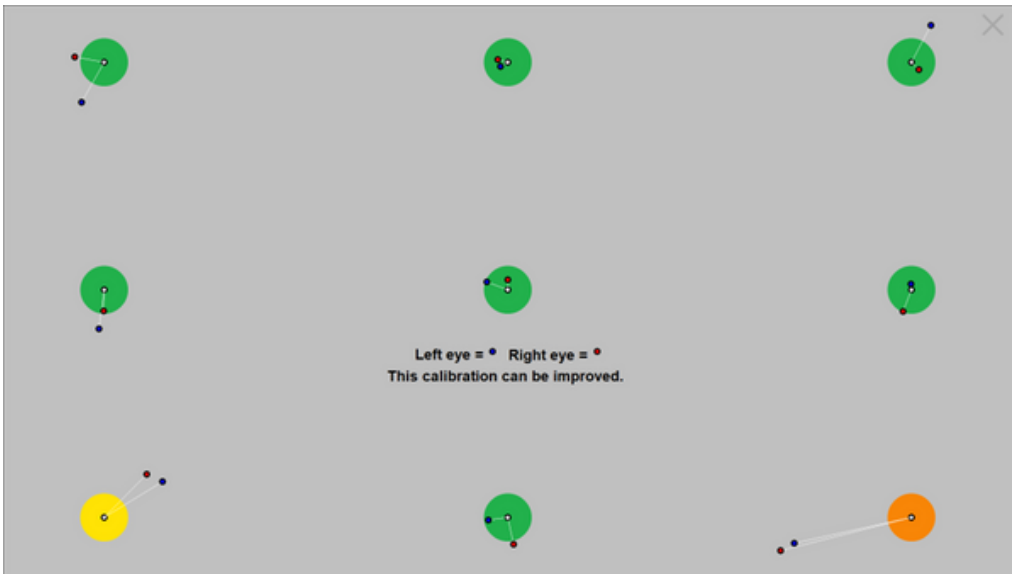

Via ME5-instellingen;
mogelijkheid om resultaten te beheren

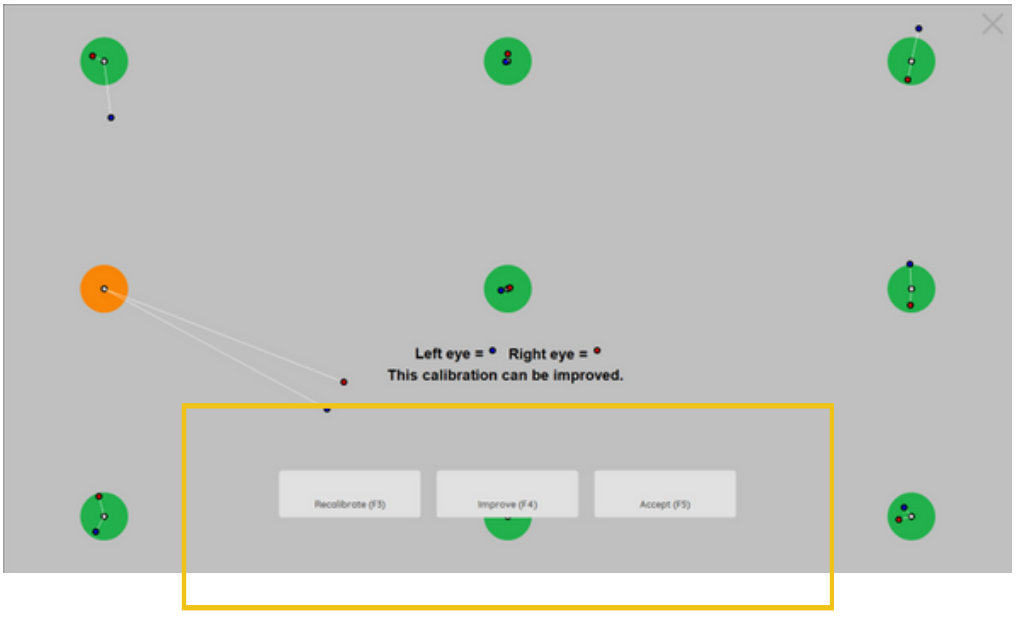

TIJDENS HET GEBRUIK
BUITEN MIND EXPRESS

1 Dankjewel om dit FAQ-item door te nemen:

Illustratie in InControl
(Menu > Importeren > Online documenten)

2 'Danst' je muisaanwijzer rond een doelitem?

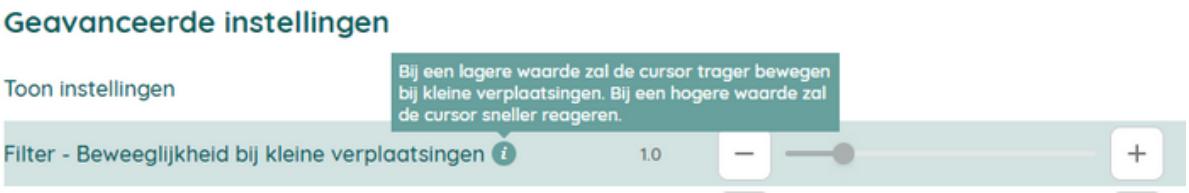

3 Verplaatst de muisaanwijzer zich 'te abrupt' over het scherm?

OOGSTURING
EHBO

1 De kalibratie blijft falen

- Positie OK? Oogmonitor!
- De kalibratie is aangepast aan de persoonskenmerken?
  - Stimulus, grootte, achtergrondkleur, aantal en spreiding punten …

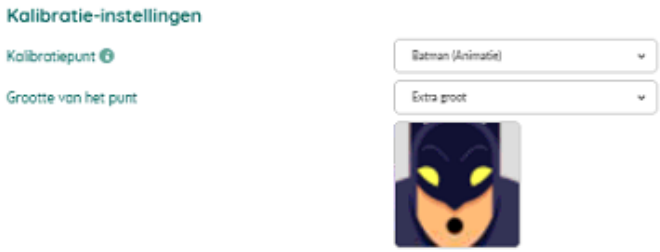

  - Aandachtspanne?
    - Handmatige kalibratie?

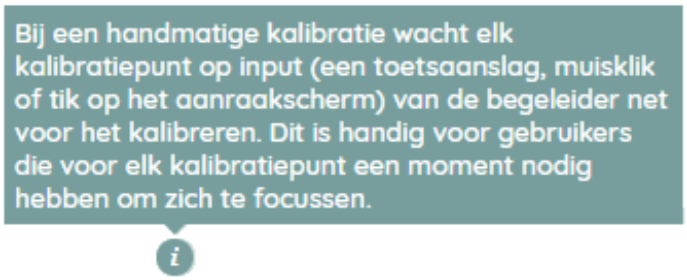

    - Willekeurige volgorde?

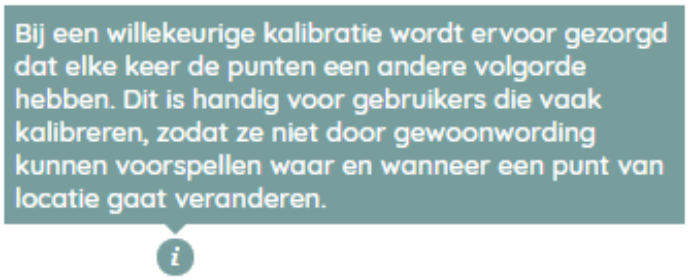

- Geen oplossing? Kan een andere persoon (idealiter met vergelijkbare oogkleur) de kalibratie doorlopen? Gebruik deze kalibratie dan voor de O.C.-gebruiker.

OOGSTURING
EHBO

2 Midas touch = selectie van vakjes, wanneer dit niet de bedoeling was

- Selectie via dwell
  - Een dwelltijd van +- 450 à 600 ms wordt vaak geciteerd als optimaal. Echter, persoonskenmerken hebben een grote invloed.
    De dwelltijd verlengen, kan niet-intentionele selecties helpen vermijden.

  - Zijn er vakjes die meer verwerkingstijd vragen (*bijvoorbeeld vakjes met woord- of zinsvoorspelling, frases en zinnen, minder frequente woordenschat ...)?*
    Je kan voor deze specifieke vakjes een langere dwelltijd opgeven.

Menu > Instellingen

Bewerken

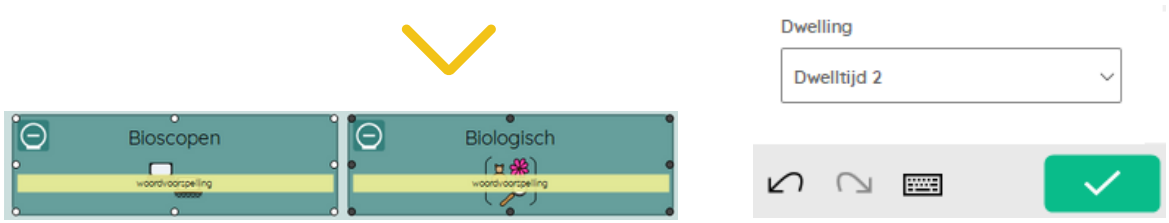

- Valt een andere selectiemethode te overwegen?
  - Selecteren via knipperen
  - Selecteren via schakelaar
    (vermijdt dwelltijd + vermoeibaarheid knipperen)

OOGSTURING
EHBO

3 Na het selecteren van een vakje, blijft Mind Express herhaald selecties uitvoeren.

- Selectie via dwell
  - Is "Dwell herhalen" actief en wenselijk?
    bv. zodat een letter onmiddellijk verdubbeld kan worden (a > aa)

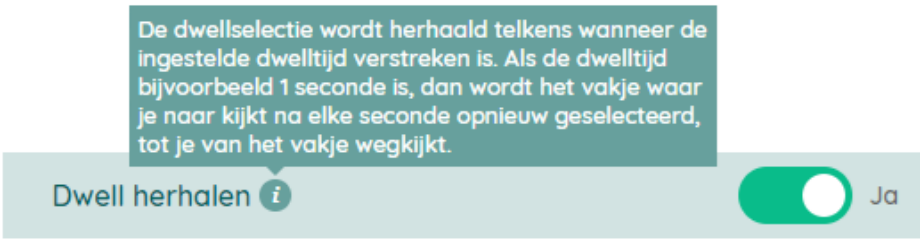

  - *Heb je een erg lange dwellgeheugentijd die ervoor zorgt dat de dwelltijd blijft lopen?*

  - *Helpt het om vakjes even niet-selecteerbaar te maken na een selectie?*

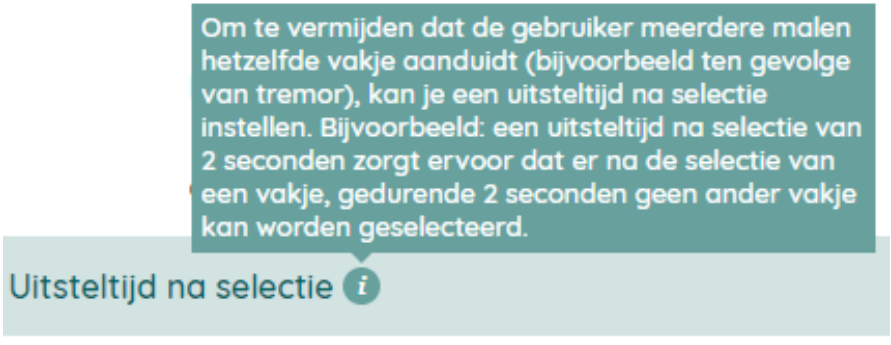

OOGSTURING
EHBO

4 Verkeerde of onvoldoende selecties binnen ME5?

- Positie OK? Oogmonitor!

- Herhaal de kalibratie. Instellingen cfr. persoonskenmerken.



- Is de selectiemethode aangepast aan de persoonskenmerken?
  - Welke methode (dwell, knipperen, schakelaar)?
  - Verschillende dwelltijden voor verschillende vakjes?

- Consistente & efficiënte positionering van vakjes
  bv. plaatsing 'terug'-knop, 'pop-up' naar kernwoordenschat, naar vaak-gebruikte-functies ..

Tip:

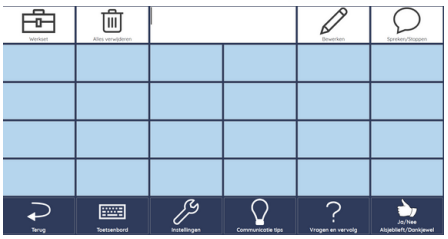

- Combinatie van bedieningsmethodes?
  bv. bij vermoeibaarheid
  illustratie: '<u>regie over je spraakcomputer</u>'